



# DEMANDATORISCHE VENTILATION




Spontane Ventilation ist durchgehend möglich.






# DEMANDATORISCHE VENTILATION




Druck

5 MBAR



# DEMANDATORISCHE VENTILATION



			
Druck 1	Zeit 1	Druck 2	Zeit 2
15 MBAR	2 SEK	5 MBAR	2 SEK
Zykluszeit: 4 SEK		Frequenz: 15 BPM	
Atemzeitverhältnis: 1 : 1			




# DEMANDATORISCHE VENTILATION




Druck 1

15 MBAR




Druck 2

5 MBAR



Frequenz

12 BPM





T<sub>ins</sub>

2 SEK


Zykluszeit: 5 SEK  
Expirationszeit: 3 SEK  
Atemzeitverhältnis: 1 : 1,5

# DEMANDATORISCHE VENTILATION

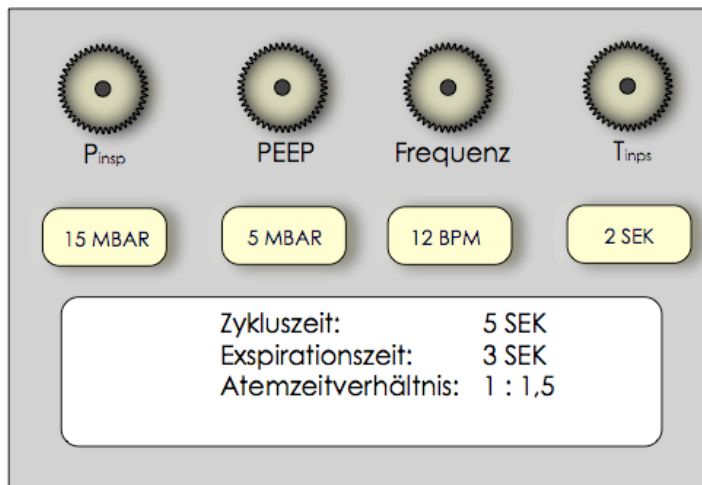




# DEMANDATORISCHE VENTILATION



 P <sub>Insp</sub>	 PEEP	 Frequenz	 T <sub>Insp</sub>
15 MBAR	5 MBAR	15 BPM	1 SEK
Zykluszeit: 4 SEK Expirationszeit: 3 SEK Atemzeitverhältnis: 1 : 3			
<b>Zeitlimitiert - Nicht Compliance adaptiv</b>			


# DEMANDATORISCHE VENTILATION



 P <sub>insp</sub>	 PEEP	 Frequenz	 T <sub>insp</sub>
25 MBAR	5 MBAR	15 BPM	3 SEK
Zykluszeit: 4 SEK Expirationszeit: 2 SEK Atemzeitverhältnis: 1,5 : 1			
<b>Zeitlimitiert - Expiration unvollständig</b>			




# DEMANDATORISCHE VENTILATION



			
$P_{\text{Insp}}$	PEEP	Frequenz	$T_{\text{Insp}}$
20 MBAR	5 MBAR	5 BPM	2 SEK


Zykluszeit: 12 SEK  
Expirationszeit: 10 SEK  
Atemzeitverhältnis: 1:5






# DEMANDATORISCHE VENTILATION



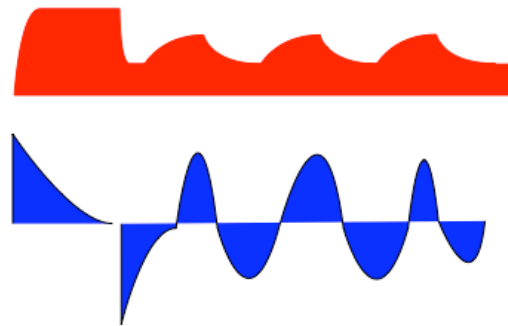

# DEMANDATORISCHE VENTILATION



				
$P_{insp}$	PEEP	Frequenz	$T_{insp}$	ASB
20 MBAR	5 MBAR	5 BPM	2 SEK	5 MBAR
Zykluszeit: 12 SEK		Expirationszeit: 10 SEK		
Atemzeitverhältnis: 1:5				

# DEMANDATORISCHE VENTILATION



Control panel for demand ventilation settings:

$P_{\text{insp}}$	PEEP	F	$T_{\text{insp}}$	ASB
8 MBAR	2 MBAR	6 BPM	9 Sek	0 MBAR

Additional parameters:

- $T_{\text{Zyklus}}$ : 10 SEK
- $T_{\text{Exp}}$ : 1 SEK
- Ratio: 9 : 1

ゾガツゼ